



Waga łózkowa najazdowa z legalizacją MS6080 z funkcją BMI z bezprzewodową transmisją danych (EMR ready)



Product codes:

Reference: MS6080

Product short description:

CHARDER MS6080 to legalizowana (klasa III) waga łózkowa. Łatwa integracja bezprzewodowa z EMR placówki medycznej (**EMR ready**). Oczywiście może też działać samodzielnie lub przysyłać pomiary bezpośrednio do 1 urządzenia.

Product description:



Cały proces następuje automatycznie - od skanowania identyfikatora pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych poprzez dodanie pomiaru wzrostu zainstalowanym na wadze wzrostomierzem oraz dalszą transmisję danych, aby wyeliminować błędy ręcznego wprowadzania danych oraz zmniejszyć obciążenie pracą personelu medycznego. Dane pomiarowe wyświetlane są również na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu wagi.


Dzięki automatycznej transmisji możesz zminimalizować błędy w transkrypcji i efektywniej spędzać czas na innych zadaniach!

Dane techniczne:



- Automatyczne wyłączenie.
- Nośność wagi: 600 kg.
- Dokładność odczytu: 100g/300 kg > 200 g
- Funkcja długoterminowego śledzenia wagi pacjenta.
- Funkcja sygnału dźwiękowego przy ustawionym wcześniej progu zmiany wagi pacjenta.
- Funkcja TARA.
- Pamięć 10 standardów TARA - czyli można zapamiętać 10 rodzajów standardowych obciążeń - np. wedle typów łóżek czy wózków inwalidzkich.
- Funkcja HOLD przy dokonywaniu pomiaru wagi ruchomego pacjenta.
- Lekkie rampy wagowe wyposażone w uchwyty do przenoszenia oraz kółka transportowe.
- Łatwy najazd na rampy - "technologia: ULTRA LOW".
- Podwójny wyświetlacz - do wyświetlania podstawowych i uzupełniających informacji.
- Kompatybilny z drukarką termiczną do wag medycznych firmy Charder
- Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)
- USB (kabel do podłączenia z PC w zestawie).

Cechy i funkcje panelu wagi CHARDER MS6080:

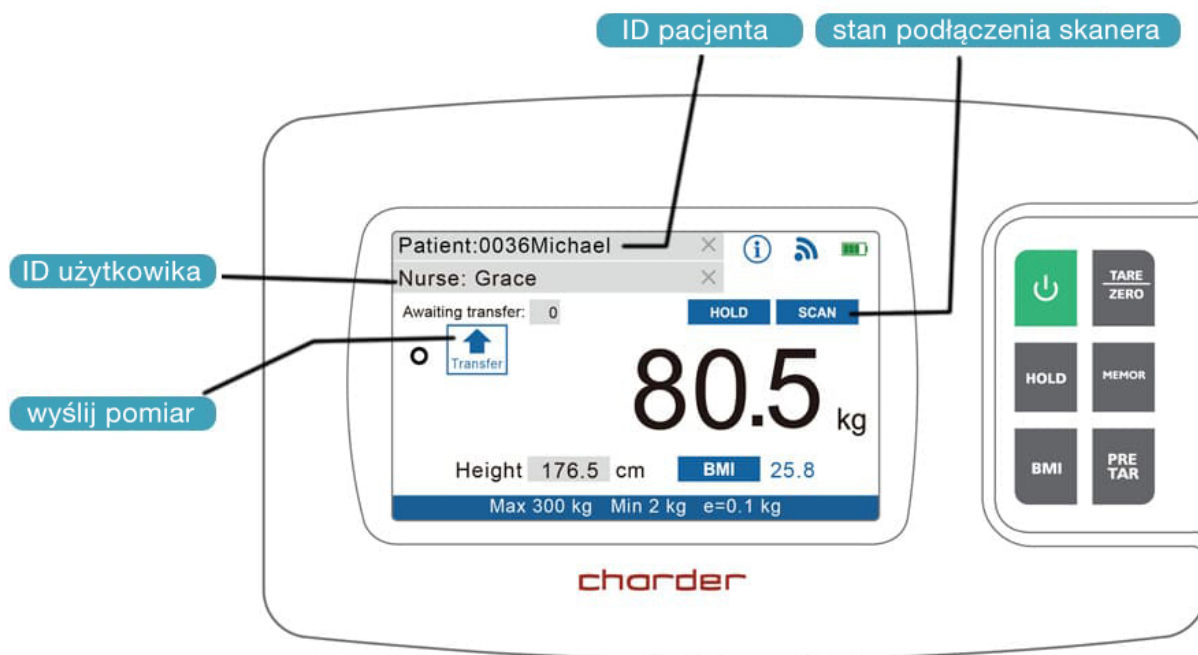

Suma cech (czytnik kodów paskowych, automatyczne przesłanie danych i możliwa łatwa integracja z systemem placówki medycznej) stawia o nowatorstwie urządzenia, które w tej formie jest kompetentną nowością na rynku.

Produkty marki Charder mimo najwyższej jakości wykonania i nowatorstwa są najczęściej tańsze od produktów konkurencyjnych.


Pomiar pacjenta przy użyciu bezprzewodowej wagi platformowej CHARDER M6080 dokonywany jest w następujących krokach:

1. Nadaj niemowlęciu identyfikator - ID pacjenta aby urządzenie mogło szybko skanować i zapisywać wyniki podczas procedury pomiarowej.
2. Wysterylizuj platformę i w razie potrzeby wprowadź odliczenie wagi przed pomiarem (PRE-TARA). Zeskanuj identyfikator użytkownika i niemowlęcia lub wprowadź ręcznie dane za pomocą ekranu dotykowego.
3. Pomiar wagi zostanie dokonany automatycznie, ustaw wzrostomierz do długości dziecka - wartość zebrana zostanie



automatycznie (przy zastosowaniu wzrostomierza elektronicznego).

4. Prześlij dane pomiaru do systemu informatycznego placówki medycznej,
5. Zobacz wyniki w systemie - Porównaj wyniki z poprzednimi pomiarami, aby przeanalizować trendy. Oprogramowanie jest bezpłatne.

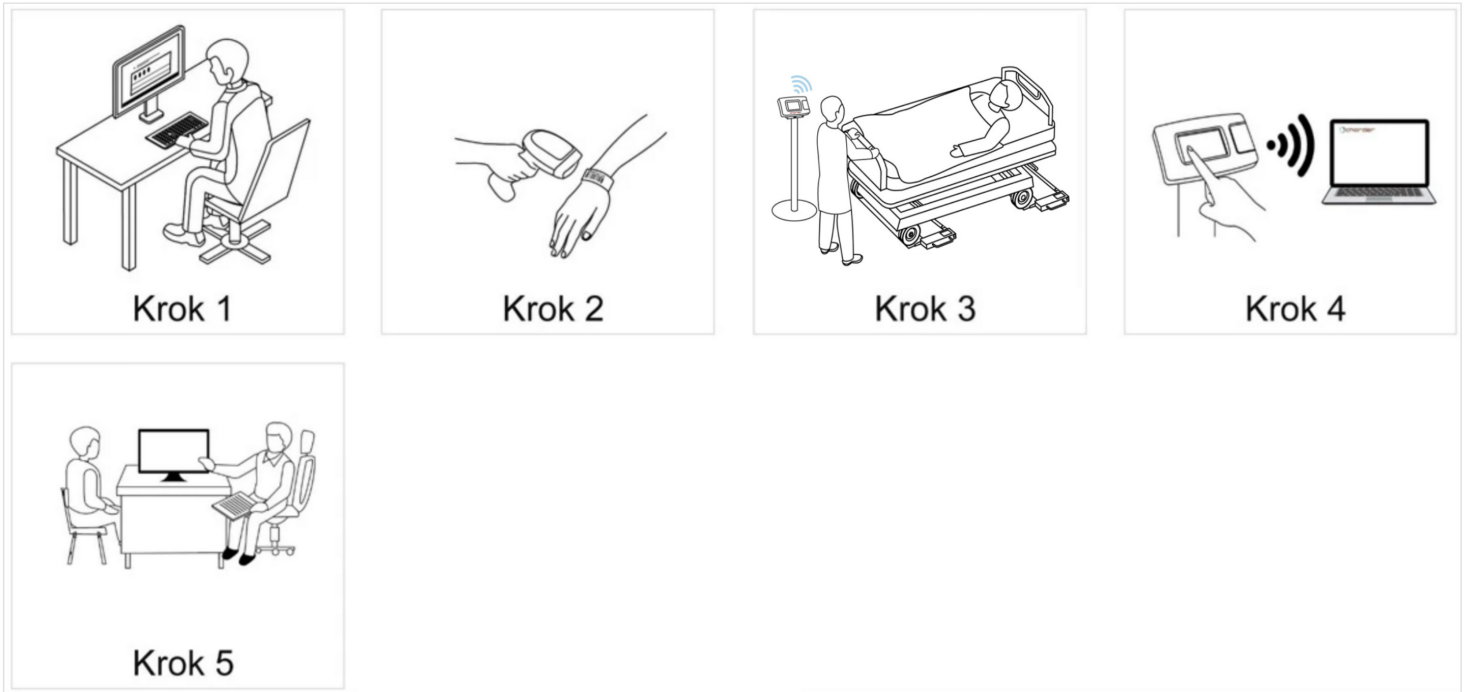

Product features:

Product attributes:

umiejscowienie panelu wagowego: na kolumnie (w zestawie), na elastycznym przewodzie dystansującym

