

Elektroniczna waga platformowa bariatryczna z legalizacją CHARDER MS3880 do 300kg z bezprzewodową transmisją danych (EMR ready)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: MS3880

Krótki opis:

Do 300 kg, z łącznością bezprzewodową, dotykowym ekranem na przewodzie/kolumnie, niską platformą, funkcją BMI, TARA, HOLD.

Opis produktu




Cały proces następuje automatycznie - od skanowania identyfikatora pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych poprzez dodanie pomiaru wzrostu zainstalowanym na wadze wzrostomierzem oraz dalszą transmisję danych, aby wyeliminować błędy ręcznego wprowadzania danych oraz zmniejszyć obciążenie pracą personelu medycznego. Dane pomiarowe wyświetlane są również na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu wagi.

Dzięki automatycznej transmisji możesz zminimalizować błędy w transkrypcji i efektywniej spędzać czas na innych zadaniach!

Dane techniczne:

- Dopuszczalne obciążenie - 300 kg,
- Dokładność odczytu - 100 g,
- Funkcja TARA, HOLD, BMI,
- Pamięć 5 standardów TARA - czyli można zapamiętać 5 rodzajów standardowych obciążeń - np. wedle typów łóżek czy wózków inwalidzkich,
- Podświetlany wyświetlacz LCD,
- USB (kabel do podłączenia z PC w zestawie)
- Poziomica do regulacji poziomu,
- Zasilanie - bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie),
- >Wymiary platformy wagi (dł. x szer. x wys.) - 1150x800x50mm. Waga posiada progi wzdłuż bocznych krawędzi zabezpieczające przed zsunięciem się wózka z platformy,
- Masa własna - 28,6 kg,
- Uchwyt i kółka do łatwego przenoszenia,
- Niski profil platformy,
- panel wagowy na przewodzie lub stojaku,
- Gwarancja - 24 miesiące,
- **Opcjonalnie** - drukarka TP 2100 Thermal, kolumna na wyświetlacz, poręcz

Cechy i funkcje panelu wagi CHARDER MS3880:

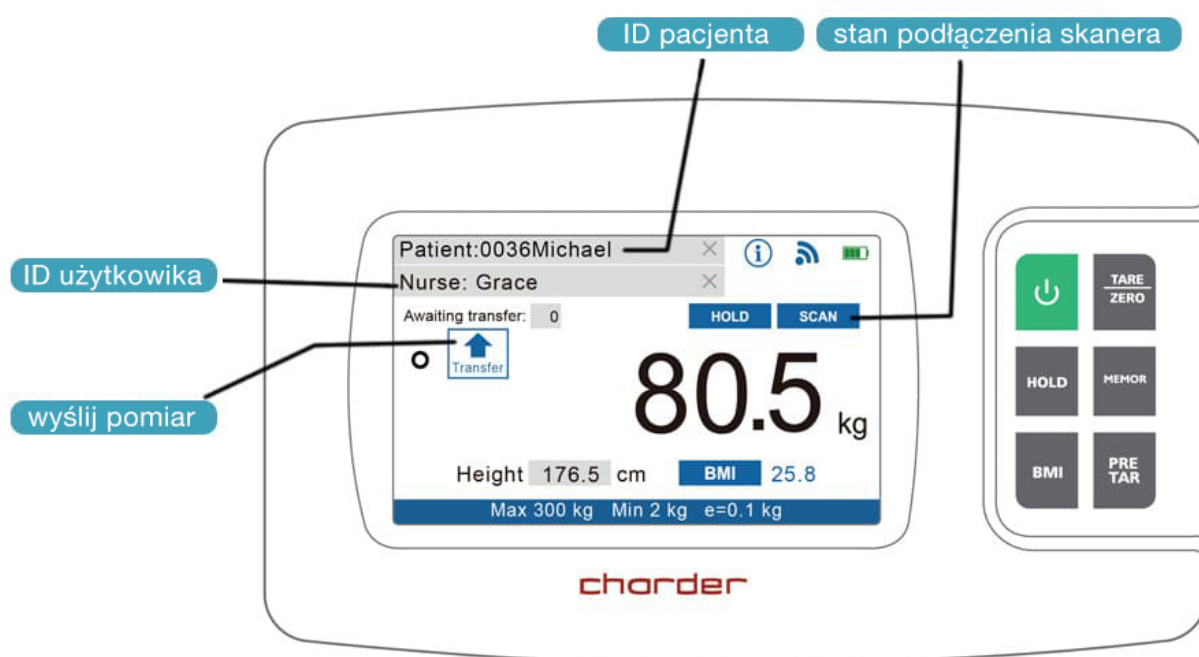

Suma cech (czytnik kodów paskowych, automatyczne przesłanie danych i możliwa łatwa integracja z systemem placówki medycznej) stawia o nowatorstwie urządzenia, które w tej formie jest kompetentną nowością na rynku.



Produkty marki Charder mimo najwyższej jakości wykonania i nowatorstwa są najczęściej tańsze od produktów konkurencyjnych.

Pomiar pacjenta przy użyciu bezprzewodowej wagi platformowej CHARDER MS3880 dokonywany jest w następujących krokach:

1. Nadaj niemowlęciu identyfikator - ID pacjenta aby urządzenie mogło szybko skanować i zapisywać wyniki podczas procedury pomiarowej.
2. Wysterylizuj platformę i w razie potrzeby wprowadź odliczenie wagi przed pomiarem (PRE-TARA). Zeskanuj

identyfikator użytkownika i niemowlęcia lub wprowadź ręcznie dane za pomocą ekranu dotykowego.

3. Pomiar wagi zostanie dokonany automatycznie, ustaw wzrostomierz do długości dziecka - wartość zebrana zostanie automatycznie (przy zastosowaniu wzrostomierza elektronicznego).
4. Prześlij dane pomiaru do systemu informatycznego placówki medycznej.
5. Zobacz wyniki w systemie - Porównaj wyniki z poprzednimi pomiarami, aby przeanalizować trendy. Oprogramowanie jest bezpłatne.

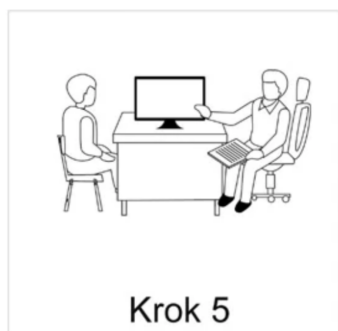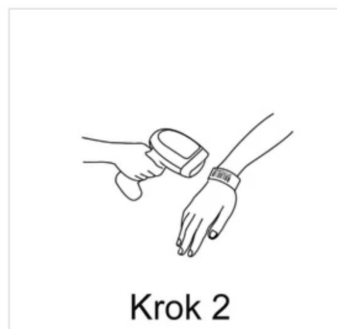

Cechy produktu:

Atrybuty produktu:

umiejscowienie panelu wagowego: na kolumnie (w zestawie), na elastycznym przewodzie dystansującym